

麻酔科


1. 概要

2013年は他院への異動が前半4名後半1名あったため、麻酔科医は8名まで減少した。前半は育休取得者も1名あった。6月に歯科麻酔科医の稲生副部長に赴任して頂いた。年間の総手術件数は7,468件であり、全身麻酔件数は3,502件であった。麻酔科管理症例は2,408件であり、そのうち麻酔科管理の全身麻酔は2,197件であった。麻酔科管理の緊急症例は542件あった。麻酔科医の人数が減った分、麻酔科管理症例が大幅に減少した。逆に歯科口腔外科症例は後半増加した。新たに気管支ビデオスコープを購入し、エアウェイスコープも9台に増えた。McGRATH™MACも購入し、挿管困難対策が増々充実した。デスフルラン気化器が4台に増えた。現在麻酔関連機器や薬剤を整備でき、全国的にも誇れる麻酔環境が整いつつある。幸いにも2014年には医長1名の赴任予定があり、院内からも2名の入局者がいて、将来に向け明るい光がさしてきている。

(第一部長 寺本 友三)

●麻酔科管理件数

総件数：2,408件

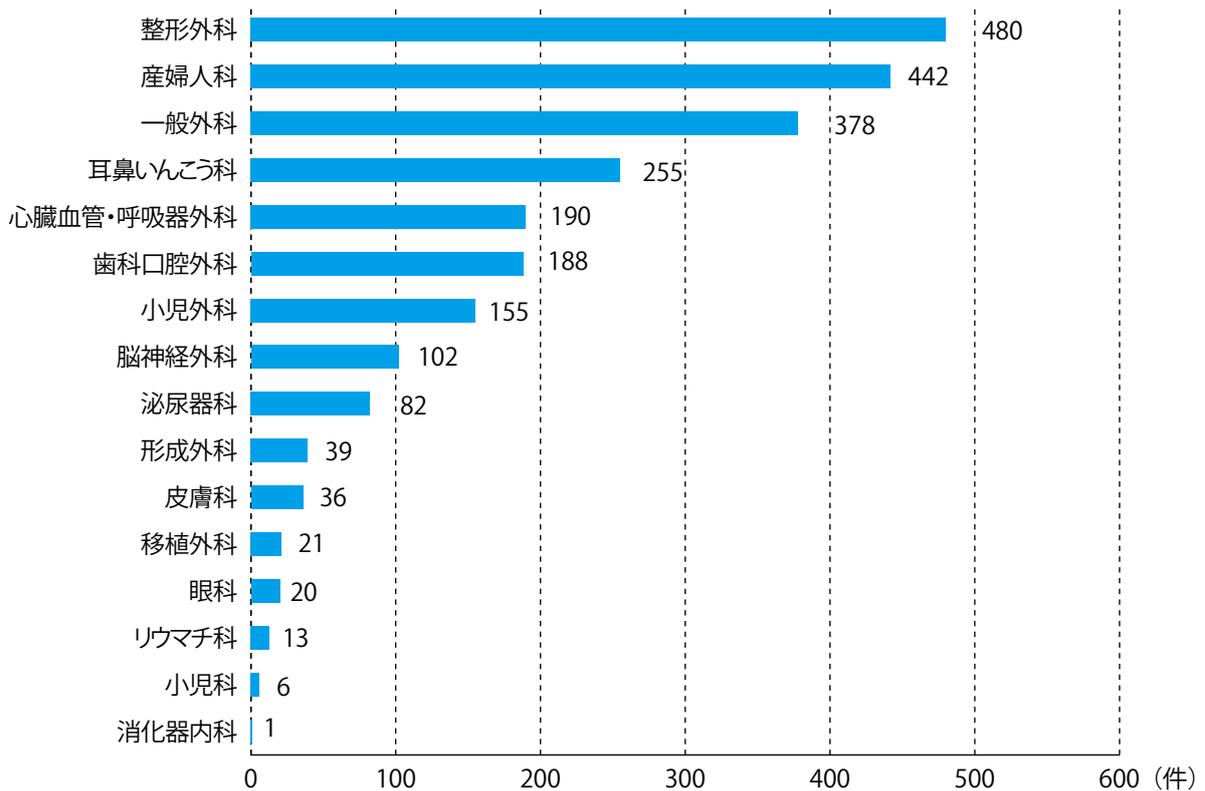

主要備品（2014年分も含む）

1. 患者監視装置

①Philips社製セントラルモニタ

IntelliVueインフォメーションセンタ …… 1式（2画面）

②Philips社製IntelliVue MP 50、70、90…（13台）

2. 手術部門システム Philips社ORSYS-TETRA 電子カルテと連動

術前術後診察機能、同意書作成機能、血中濃度シュミレーター付、縦型19インチタッチパネルモニタ13台、看護端末14台とデータ連係、ステータスマニタ5台、管理端末6台、Web機能によりすべての電子カルテ端末より参照可

3. 超音波診断装置

①心臓麻酔用GE社製 Vivid i …… 1台

②中心静脈穿刺用GE社製 Venue40 Anesthesia …… 1台

③神経ブロック用ソノサイト社製 S-Nerve …… 1台

4. 静脈麻酔システム

①テルモ社製ディプリバン専用TCIポンプ …… 14台

②テルモ社製シリンジポンプ… 55台

（手術室内麻酔科専用分のみ）

③集中電源装置と架台… 13式

（手術室4部屋分が最新型、手術室10部屋分が通常型）

5. 挿管支援器具

①ペンタックス社製 エアウェイスコープ… 9台

②McGRATH™ MAC …… 6台

学会発表（医局）

<麻酔科>

※丸数字は共同研究者を示す

No.	演 題 名	発表者及び 共同研究者	学会・研究会名	発表年月日
①	全身麻酔下帝王切開中に痙攣発作を起こした症例	伴野 なつ美	日本麻酔科学会 東海・北陸支部第11回学術集会	2013/9/14
②	当院におけるデスフルラン使用の現状	石井 菜々子	日本麻酔科学会 東海・北陸支部第11回学術集会	2013/9/14
③	大動脈弁狭窄症、兼閉鎖不全症、僧帽弁閉鎖不全症、低心機能を合併した透析患者の右下肢切断術に対しレミフェンタニル主体に全身麻酔管理し得た1例	李 越	日本麻酔科学会 東海・北陸支部第11回学術集会	2013/9/14
④	内頸動脈閉塞症に対し緊急手術となったが、執刀直前に凝固異常にて手術中止となった一症例	川口 道子	日本麻酔科学会 東海・北陸支部第11回学術集会	2013/9/14
⑤	硬膜外麻酔にて全脊椎麻酔となり、ショック状態となった患者に対し、全身麻酔にて帝王切開を行った一症例	川口 道子	日本麻酔科学会 東海・北陸支部第11回学術集会	2013/9/14